


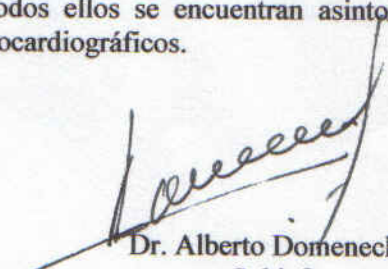

HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires
150 años de vida

Informe sobre la utilización de anillos Surgiflex para Plásticas Valvulares

Los anillos Surgiflex comenzaron a ser utilizados en este Servicio en Julio de 2006. Desde esa fecha se han implantado en 9 Pacientes: 8 en posición Mitral y uno en válvula tricúspide. En 8 oportunidades se utilizó el tipo hemianillo posterior y en 1 el anillo completo. La técnica de implante fue la clásica, con puntos separados de Ticron 2/0 colocados en forma paralela al anillo mitral, y en todos los casos en los que se implantó en dicha válvula, la etiología de la Insuficiencia valvular fue degenerativa por Prolapso valvar (tipo II de Carpentier). En el Paciente con Insuficiencia Tricuspídea la etiología fue por dilatación anular. En todos los casos se efectuó control intraoperatorio mediante ecocardiograma transesofágico, logrando ausencia de reflujo residual o reflujo trivial. Las características de diseño del anillo permiten una aceptable facilidad para pasar los puntos de fijación al anillo valvular, generando una adecuada reducción uniforme del área valvular. Para esto es necesario colocar puntos no muy extensos, con lo que se impide el fruncido del anillo protésico. Actualmente se está en el proceso de rediseño del marco de sostén del anillo. El seguimiento de los pacientes es del 100%. Todos ellos se encuentran asintomáticos, y presentan buena función valvular en los controles ecocardiográficos.


Dr. Alberto Domenech
Subjefe
Servicio de Cirugía Cardiovascular

Buenos Aires, 8 de abril de 2007

Dr. ALBERTO DOMENECH
SUBJEFE
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
MATR. PROF. 67.266



SERVICIO CERTIFICADO BAJO NORMAS DE CALIDAD ISO 9001:2000

Gascón 450 (C1181 ACH) Buenos Aires, Argentina

Teléfono-Fax Directos: (5411) 4958-5836 / 2464 Conmutador Hospital Italiano: (5411) 4959-0200 Internos: 8202/8253/54